



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54

tel./fax. (82) 564 04 56

NIP 563-207-76-08, REGON 110607010

K-ZP.251.43.2020

Chełm, 30 września 2020 r.

### WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą **Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące pytania:

#### Zadanie nr 13

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o szerokości 40 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o szerokości 40 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 , 3) o wysokości 80 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową (Poz. 1, 2 ,3) o wysokości 80 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne ze szczytami bez zabezpieczenia/blokady szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko szpitalne ortopedyczne ze szczytami bez zabezpieczenia/blokady szczytów. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy (poz. 2 i 4) z regulacją wysokości w zakresie 69-104 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stolik przyłóżkowy (poz. 2 i 4) z regulacją wysokości w zakresie 69-104 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

mf

5. Czy Zamawiający dopuści łózko (poz. 1 i 3) wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków, co nie wpływa na funkcjonalność łóżek?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łózko (poz. 1 i 3) wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
6. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeń.
7. Czy Zamawiający dopuści łózko domowe o długości całkowitej 218 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łózko domowe o długości całkowitej 218 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
8. Czy Zamawiający dopuści łózko domowe z regulacją segmentu podudzia mechaniczną (ręczną)?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łózko domowe z regulacją segmentu podudzia mechaniczną (ręczną) . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
9. Czy Zamawiający dopuści łózko domowe z kołami bez właściwości antystatycznych (parametr zbędny w tego typu łóżkach)?
- Odpowiedź:** Zamawiający NIE łózko domowego z kołami bez właściwości antystatycznych. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
10. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy (poz. 4) z możliwością pochylenia blatu o kąt 30 stopni i 60 stopni?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stolik przyłóżkowy (poz. 4) z możliwością pochylenia blatu o kąt 30 stopni i 60 stopni . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (pozycja 5), która nie jest wyrobem medycznym?
- Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową (pozycja 5), która nie jest wyrobem medycznym pod warunkiem spełnienia wymagań dla tego wyrobu dopuszczającego do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadając (jeżeli są wymagane) certyfikaty, dopuszczenia, atesty materiałowe materiałów użytych do produkcji o właściwościach nie gorszych niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wymaganiami SIWZ do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające równoważność produktu do wymagań postawionych w OPZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



### Zadanie nr 16

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów


#### Pkt.1

Prosimy o dopuszczenie podstawy obrotowej z uchwytem pod nogi, umożliwiającej transfer obrotowy pacjenta, o średnicy 41,5-42 cm, o udźwigu do 135 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności podstawę obrotową z uchwytem pod nogi, umożliwiającą transfer obrotowy pacjenta, o średnicy 41,5-42 cm, o udźwigu do 135 kg. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### Pkt.3


Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej, wykonanego z poliamidu, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, z uchwytami wokół 2 boków, po 4 po każdej ze stron, o wymiarach: 200 x 90 cm, jak na rysunku poniżej:

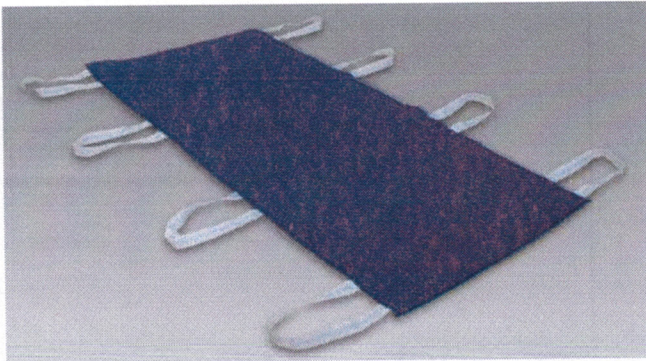

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łatwoślizg do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej, wykonanego z poliamidu, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 150 kg, z uchwytami wokół 2 boków, po 4 po każdej ze stron, o wymiarach: 200 x 90 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### lub

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu składającego się z łamanej deski, wykonanej z tworzywa, nie zawierającej lateksu, o wymiarach 180 x 50 cm (90 x 50 cm – po złożeniu) oraz z zewnętrznej taśmy ślizgowej, przeznaczonego do przesuwania pacjentów o wadze do 135 kg (przy 20 cm przerwie między powierzchniami), jak na rysunku poniżej:

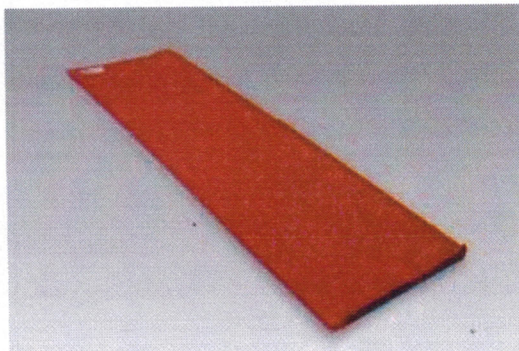

wp



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łatwoślizg składającego się z łamanej deski, wykonanej z tworzywa, nie zawierającej lateksu, o wymiarach 180 x 50 cm (90 x 50 cm – po złożeniu) oraz z zewnętrznej taśmy ślizgowej, przeznaczonego do przesuwania pacjentów o wadze do 135 kg (przy 20 cm przerwie między powierzchniami). Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie pasa do podnoszenia i przemieszczania pacjenta o wymiarach: 60 x 20 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pasa do podnoszenia i przemieszczania pacjenta o wymiarach: 60 x 20 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie krótkiej deski do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek o wymiarach: 75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności krótką deskę do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek o wymiarach: 75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego o wymiarach: 640 x 360 mm lub 760 x 360 mm i udźwigu do 160 kg, wykonanego z ramy aluminiowej, materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję, rolki pokryte materiałem imitującym skórę, kolor czarny

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przenośnik taśmowo-rolkowego o wymiarach: 640 x 360 mm lub 760 x 360 mm i udźwigu do 160 kg, wykonanego z ramy aluminiowej, materiał odporny na zniszczenia i dezynfekcję, rolki pokryte materiałem imitującym skórę, kolor czarny. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści łatwoślizg do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej z uchwytami wokół 3 boków, o wymiarach: 200 x 90 cm, jak na rysunku poniżej:

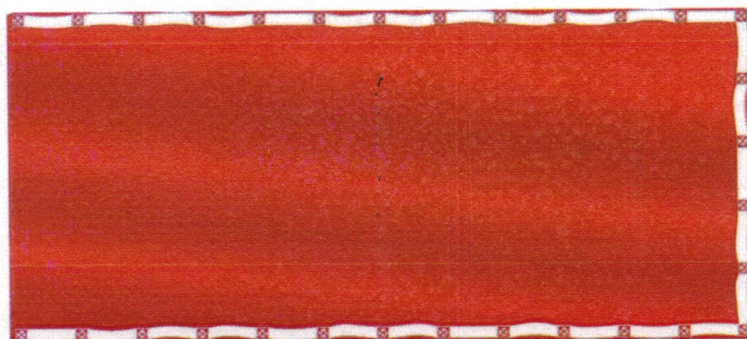



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łatwoślizg do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej z uchwytami wokół 3 boków, o wymiarach: 200 x 90 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### **Zadanie nr 17**

##### **Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej**

###### Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zmiennociśnieniowego, wytrzymałego materaca z poliuretanowymi komorami, napełnianymi przez pompę. Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 200 x 85 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zmiennociśnieniowy, wytrzymały materac z poliuretanowymi komorami, napełnianymi przez pompę. Dopuszcza materac o wymiarach 200 x 85 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

###### Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 200 x 85 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności materac o wymiarach 200 x 85 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

###### Poz. 3


Prosimy o dopuszczenie zestawu poduszek do pozycjonowania pacjenta wykonanych z włókien poliestrowych i pianki HR lub tylko z pianki HR, przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny, wyposażonych w pokrowce zewnętrzne, higieniczne, paroprzepuszczalne, zmywalne, odporne na uszkodzenia, zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz, zapinane na suwak, przeznaczone do prania w 95°C oraz do czyszczenia powierzchniowego środkami na bazie alkoholu, z lub bez środków powierzchniowo czynnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zestawu poduszek do pozycjonowania pacjenta wykonanych z włókien poliestrowych i pianki HR lub tylko z pianki HR, przyjemnych w dotyku, miękkich, zapewniających wysoki poziom higieny, wyposażonych w pokrowce zewnętrzne, higieniczne, paroprzepuszczalne, zmywalne, odporne na uszkodzenia, zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz, zapinane na suwak, przeznaczone do prania w 95°C oraz do czyszczenia powierzchniowego środkami na bazie alkoholu, z lub bez środków powierzchniowo czynnych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

###### Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie poduszki, przeznaczonej do wsparcia tułowia o wymiarach: 85x65x30 cm, jak na rysunku poniżej:




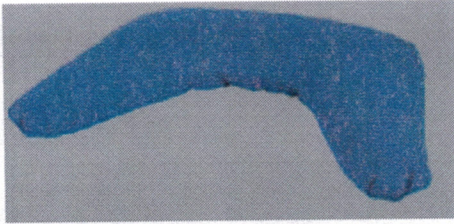

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

lub

Prosimy o dopuszczenie zakrzywionej poduszki o wymiarach: 120x75x30 cm, jak na rysunku poniżej:

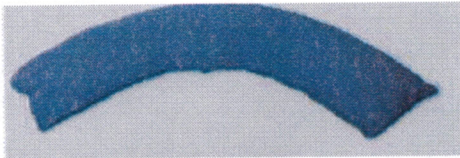

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod kark o średnicy 38 lub 50 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu 38 i 50 cm. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pkt. 4


Prosimy o dopuszczenie poduszki stabilizującej, wielokomorowej o wymiarach: 45x45 cm oraz 60x70 cm, jak na rysunku poniżej:

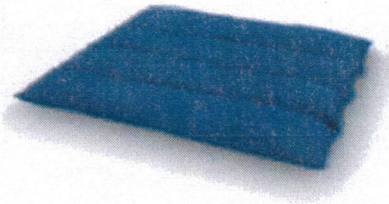

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki stabilizującej, wielokomorowej o wymiarach: 25x80 cm, jak na rysunku poniżej:



mf



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie wałka w rozmiarze: 15x60 cm wraz z poduszką do odwodzenia kolan

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wałek o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pkt. 6, 7


Prosimy o dopuszczenie poduszki do odwodzenia kolan i stabilizacji miednicy o wymiarach: 35x55 cm lub 54x78 cm, jak na rysunku poniżej:

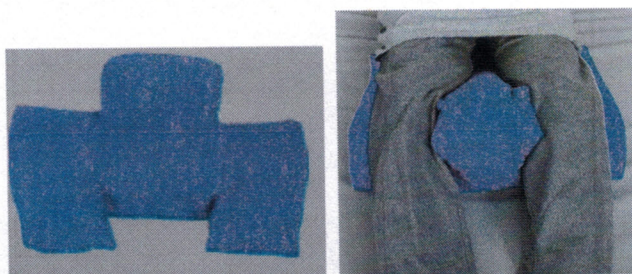

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki trójkątnej, w kształcie klina o wymiarach: 62x35x35 cm, jak na rysunku poniżej:

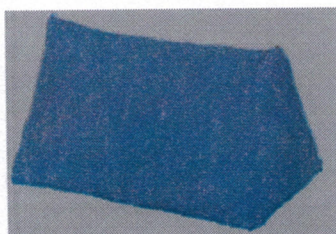

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki wielokomorowej, do wykorzystania jako separator kolan w pozycji na boku, o wymiarach: 70x60 cm, jak na rysunku poniżej:





**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie poduszki wielokomorowej, do wykorzystania jako podparcie nóg w pozycji na wznak, o wymiarach: 70x60 cm, jak na rysunku poniżej:



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie poduszki trójkątnej, w kształcie klina o wymiarach: 70x26x15/5 cm, jak na rysunku poniżej:



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki do podparcia pleców o wymiarach: 50x85 cm, jak na rysunku poniżej

ml






**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki do podparcia pleców w formie węża o wymiarach: 20x125 cm lub 20x225 cm lub poduszki zakrzywionej o wymiarach: 125x75x30 cm, jak na rysunkach poniżej;



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Poz. 10


Prosimy o dopuszczenie poduszki w kształcie sześcianu, składającej się z wielu małych kostek, które uginają się niezależnie i dostosowują do kształtu ciała, zapewniają wsparcie i wyrównują ciśnienie na całej powierzchni, a poduszka łagodzi ból i tkliwość oraz zapobiega powstawaniu odleżyn, o wymiarach 50x50x6 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszki o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.



Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie specjalistycznych pozycjonerów pięt w kształcie opaski, zapobiegających odleżynom na piętach, w rozmiarach S- 1 szt., M - 2 szt., L – 2 szt., jak na rysunku poniżej:

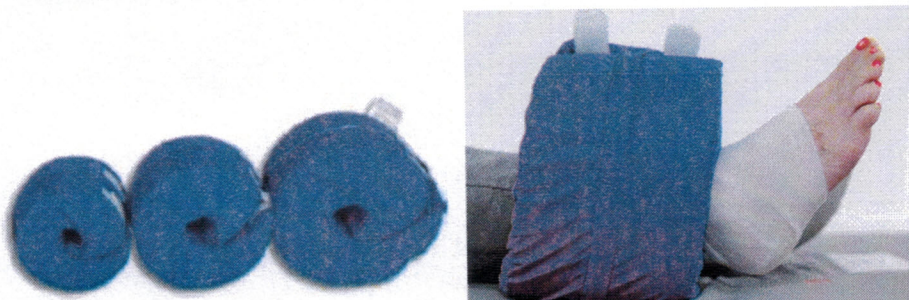

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pozycjonery o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod głowę, zapobiegającej odleżynom na uchu, o wymiarach: 32x32 cm, jak na rysunku poniżej:



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie profilowanej poduszki pod głowę, o wymiarach: 30x48x11/9 cm, jak na rysunku poniżej:



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Lub

Prosimy o dopuszczenie poduszki pod głowę, o wymiarach: 50x60 cm lub 50x85 cm, jak na rysunku poniżej:

ml





**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności poduszkę o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### **Zadanie nr 18**

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów

##### Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego ze stali malowanej epoksydowo.

Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje podnośnika z podstawą otwieraną elektrycznie czy mechanicznie?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności podnośnik wykonany ze stali malowanej epoksydowo. Zamawiający nie precyzuje zapisów w zakresie regulacji podstawy. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

#### **Zadanie 8**

1. Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści inkubator z panelem sterowania umieszczonym w kolumnie ogrzewacza, bez ekranu LCD, ale z wyświetlaczami LED: stopera APGAR, temperatury ciała noworodka i zadanej oraz z panelem przycisków funkcyjnych, przycisków sterowania oraz wskaźników?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności inkubator z panelem sterowania umieszczonym w kolumnie ogrzewacza, bez ekranu LCD, ale z wyświetlaczami LED: stopera APGAR, temperatury ciała noworodka i zadanej oraz z panelem przycisków funkcyjnych, przycisków sterowania oraz wskaźników . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści test systemu z interakcją z personelem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności test systemu z interakcją z personelem. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści inkubator w kolorystyce: biały, szary i niebieski bez możliwości zmiany kolorów? Pragniemy zwrócić uwagę, że kolorystyka nie ma znaczenia klinicznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności inkubator w kolorystyce: biały, szary i niebieski bez możliwości zmiany kolorów. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



#### Zadanie 11, poz. 5

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 11, aparat EKG (poz.5) do osobnego pakietu? W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w SIWZ i określenie kwoty wadium, jakim powinna być zabezpieczona oferta, składana na nowo utworzone zadanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE wyraża zgody. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem na papierze o szerokości 80 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności aparat EKG z wydrukiem na papierze o szerokości 80 mm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści czułość 2.5; 5; 10; 20; 10/5 mm/mV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności aparat EKG z czułością 2.5; 5; 10; 20; 10/5 mm/mV. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

7. Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści prędkość zapisu: 5; 12.5; 25; 50 mm/s?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności aparat EKG z prędkością zapisu: 5; 12.5; 25; 50 mm/s. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### Załącznik nr 4 Wzór umowy

1. **Par. 6** Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej i dodanie zapisu: *"Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową."*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy wzoru umowy zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający postępuje w sposób profesjonalny i odpowiedzialny z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

2. W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego



postępowania, zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodanie do wzoru umowy paragrafu o następującej treści:

- 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
- 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
- 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy wzoru umowy pozostają w formie niezmienionej. Jednocześnie wyjaśniamy, że zastosowane zapisy umowy umożliwiają elastyczną reakcję na zmieniające się warunki realizacji umowy mające wpływ na termin dostawy biorąc pod uwagę okoliczności, czynniki których nie dało się przewidzieć w chwili złożenia oferty i podpisania umowy. Zamawiający postępuje w sposób profesjonalny i odpowiedzialny z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

**Pytanie:**

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy do 60 dni od podpisania umowy? Obecnie



podany termin dostawy, w przypadku wydłużających się procedur przetargowych, może okazać się zbyt krótki na właściwe wywiązanie się z zapisów umowy. Dodatkowo sytuacja COVID-19 wciąż jest nieprzewidywalna, wpływa w sposób znaczący na terminy dostaw, a w przypadku fantomów większość wskazanych przez Zamawiającego modeli jest produkowana poza obszarem Europy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Podane terminy realizacji są odpowiednie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16 i 17 z zadania nr 6? Obecne zestawienie fantomów powoduje ograniczoną możliwość składania ofert większej liczbie wykonawców, ze względu na wyłączność dystrybucji dla jednej firmy w Polsce na niektóre z wymienionych pozycji. Rozbicie zadania na odrębne pakiety zapewni Zamawiającemu dużą liczbę konkurencyjnych ofert oraz lepsze ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zadane pytania nie dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach oraz nie wskazuje możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych do wskazanych parametrów minimalnych oraz wniosków o dopuszczenie na zasadzie równoważności. Zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do konkretnych zapisów opz. w poszczególnych pozycjach. Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku przed ogłoszeniem postępowania i uzyskał potwierdzenie możliwości złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta na wskazany zakres zadania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator transportowy posiadający tryb IPPV, którego funkcjonalność odpowiada trybowi A/C – tryb wentylacji kontrolowanej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zadane pytanie nie wskazuje na pełne określenie – nazwy określonej skrótem IPPV. Zamawiający nie może zidentyfikować czy wskazany skrót określa sposób realizacji parametrów wentylacji równoważny do zapisu wymaganego trybu wentylacji A/C.

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator bez funkcji blokowania przycisków ale zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **Dotyczy: Zadanie nr 13**

pozycja nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm oraz po przedłużeniu 2330mm?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko o długości całkowitej 2180mm oraz po przedłużeniu 2330mm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego ABS (jednolite odlewy), o wysokości 81cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza szafki o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego ABS. Zamawiający dopuszcza wysokość szafki 81 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

pozycja nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego ABS (jednolite odlewy), o wysokości 81cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza szafki o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego ABS. Zamawiający dopuszcza wysokość szafki 81 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

pozycja nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 219cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko o długości całkowitej 219cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami opuszczanymi poniżej poziomu materaca?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko z barierkami opuszczanymi poniżej poziomu materaca. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego ABS (jednolite odlewy), o wysokości 81cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza szafki o konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego ABS. Zamawiający dopuszcza wysokość szafki 81 cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

pozycja 4

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 86cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko z leżem o szerokości 86cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 218cm, szerokości 99,5cm oraz z regulacją wysokości leża w zakresie 37 – 73,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności o długości 218cm, szerokości 99,5cm oraz z regulacją wysokości leża w zakresie 37 – 73,5cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia za pomocą mechanizmu rastrowego?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia za pomocą mechanizmu rastrowego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji pozycji Trendelenburga?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza łóżko bez regulacji pozycji Trendelenburga. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 100mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności z kołami o średnicy 100mm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 1 kołem antystatycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza łóżka z 1 kołem antystatycznym. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wykończeniem z tworzywa Polipropylen w kolorze beżowym lub niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza łóżka z wykończeniem z tworzywa Polipropylen w kolorze beżowym lub niebieskim. Pytanie jest nieprecyzyjne. Zamawiający nie może zidentyfikować czy chodzi o zastąpienie całkowicie wymogu – „Wykończenie drewniane” czy też wprowadzenie elementów dekoracyjnych z tworzywa. Prosimy o precyzyjne zadanie pytania o jakie elementy łóżka chodzi.

pozycja 5

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach szerokość 47,5cm oraz głębokością 47,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę o wymiarach szerokość 47,5cm oraz głębokością 47,5cm. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 15\_ Wózki reanimacyjne

Poz. nr 1 - Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.

Poz. nr 2 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

Poz. nr 3 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

**Ad.4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne i tylna wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) malowane proszkowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z



możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne i tylna wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) malowane proszkowo. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Ad.5\_Ad.9**\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z blatem z wytrzymałego tworzywa ABS, z pogłębieniem, z trzema ergonomicznymi uchwytami do prowadzenia wózka, po bokach i z tyłu wózka, wyprofilowanymi w blacie. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z blatem z wytrzymałego tworzywa ABS, z pogłębieniem, z trzema ergonomicznymi uchwytami do prowadzenia wózka, po bokach i z tyłu wózka, wyprofilowanymi w blacie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Ad.7**\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z nadstawką ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych transparentnych pojemników z tworzywa.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z nadstawką ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych transparentnych pojemników z tworzywa. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Ad.9**\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uchwytem na kropłówkę z 2 haczykami, mocowanym do nadstawki, bez regulacji wysokości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z uchwytem na kropłówkę z 2 haczykami, mocowanym do nadstawki, bez regulacji wysokości. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Ad.9**\_Czy Zamawiający dopuści wyposażenie wózka w uniwersalny uchwyt z pasem mocującym z możliwością regulacji pozwalający na umieszczenie pojemników na ostre narzędzia o różnej pojemności, zamiast koszyka na akcesoria.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z uniwersalnym uchwytem z pasem mocującym z możliwością regulacji pozwalający na umieszczenie pojemników na ostre narzędzia o różnej pojemności, zamiast koszyka na akcesoria. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Ad.10**\_Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz na odpady z tworzywa otwierany kolanem, zamiast kosza z pokrywą wahadłową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, wyposażony w kosz na odpady z tworzywa otwierany kolanem, zamiast kosza z pokrywą wahadłową. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**Ad.11\_** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który w standardzie posiada z boku wózka trzy uchylne, transparentne kieszenie z tworzywa, z przeznaczeniem np. na drobny sprzęt. Oferowany parametr zwiększa wartość użytkową wózka.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, z posiadający z boku wózka trzy uchylne, transparentne kieszenie z tworzywa, z przeznaczeniem np. na drobny sprzęt. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **Zadanie nr 17\_ Wózki reanimacyjne**

Poz. 1. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt. (poz. 5 z wniosku o dofinansowanie)

Poz. 2 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt. (poz. 7 z wniosku o dofinansowanie)

Poz. 3. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt. (poz. 32 z wniosku o dofinansowanie)

**Ad.4\_** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne z anodowanego aluminium, tylna ściana wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) - malowane proszkowo.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

mf





**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek, którego szuflady (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), posiadające ergonomiczny uchwyt (wyprofilowany z ABS) na całej długości szuflady. Szuflady z możliwością opisu zawartości, z pełnym wysuwem, wyjmowane. Ściany boczne i tylna wózka z kompozytu aluminiowego (konstrukcja 3-warstwowa: aluminium-polietylen-aluminium) malowane proszkowo. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **Pytania - dotyczące SIWZ oraz projektu umowy dla:**

##### **Zadanie nr 17\_ Wózki reanimacyjne**

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia z obsługi, konserwacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, jak również montażu. Oferowane wyroby (wózki) dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych sprzętów przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Ponadto prośba ta wydaje się tym bardziej zasadna w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie, żadnych zmian. Zamawiający wraz z dostawą kupuje usługę montażu i uruchomienia, przeszkolenia która obejmuje np.: wniesienia do miejsca zamontowania, rozpakowania, sprawdzenia kompletności dostawy i stwierdzenia braku uszkodzeń okółotransportowych, zamontowania elementów ruchomych, posprzątania pozostałości opakowań zgodnie z zasadami segregacji śmieci, przeszkolenia personelu z zakresu sposobu



zamykania, otwierania, montażu i demontażu elementów ruchomych etc.. Sposobu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji /w tym w miejscach trudnodostępnych/. W trakcie dostawy Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy miejsce montażu bez obecności dodatkowych osób nie zaangażowanych w realizację dostawy oraz niezbędne środki dezynfekcyjne. Personel Zamawiającego będzie stosował środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). Bezpośrednia dostawa i fachowy montaż, rozpakowanie, uruchomienie, szkolenie przez personel Wykonawcy pozwoli skrócić czas tych czynności i nie zaangażuje dodatkowego personelu Zamawiającego (np.: do odbioru przesyłek transportowych, wniesienia do miejsca montażu itd.). Zgodnie z zapisami umowy „§3 Warunki dostawy 1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres: PWSZ w Chełmie, 22-100 Chełm. 2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do Zamawiającego, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. 3. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi. 4. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem bez zastrzeżeń, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. 8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia i montażu.” Zamawiający nie może sporządzić takiego protokołu i dokonać odbioru przedmiotu Zamówienia bez obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **Zadanie 12\_ Panele medyczne**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na cewniki wykonany z metalu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności pojemnik na cewniki wykonany z metalu

**KANCLERZ**  
*Kosiński*  
**mgr Jacek Kosiński**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Chełmie  
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54  
NIP 563-20-77-608 REGON 110607010